



Hillrom

**Welch Allyn
iExaminer Pro**



Welch Allyn iExaminer Pro-appen

238-3 Welch Allyn MacroView Plus-otoskop

118-3 Welch Allyn PanOptic Plus-ofthalmoskop

11840-IEX Welch Allyn SmartBracket-enhet

Bruksanvisning

Programvaruversion 3.3.x

Android

Driftsläge: Se aktuell huvudbruksanvisning.

© 2026 Welch Allyn, Inc. Med ensamrätt. Det är inte tillåtet att i någon form reproducera eller kopiera denna handbok eller delar av den utan tillstånd från Welch Allyn. Welch Allyn är ett varumärke som tillhör Welch Allyn, Inc. Hillrom är ett varumärke som tillhör Hill-Rom Services, Inc.

Android och Google Play är varumärken som tillhör Google, Inc. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Hill-Rom förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i design, specifikationer och modeller. Den enda produktgaranti Hill-Rom lämnar är den uttryckliga skriftliga garanti som medföljer vid inköp eller inhyrning av dess produkter.

Welch Allyn, Inc. ("Welch Allyn") påtar sig inget ansvar för personskador som kan uppstå på grund av (i) underlåtenhet att använda produkten på rätt sätt i enlighet med anvisningarna, försiktighetsåtgärderna, varningarna eller uttalandet om avsedd användning som publiceras i den här handboken eller (ii) olaglig eller felaktig användning av produkten.

PATENT hillrom.com/patents

kan omfattas av ett eller flera patent. Se internetadressen ovan. Hill-Rom-företagen är innehavare av europeiska, amerikanska och andra patent och patentansökningar under utredning.

Welch Allyn's tekniska support

<https://hillrom.com/en-us/about-us/locations>

Meddelande till användare och/eller patienter i EU: Alla allvarliga incidenter som har inträffat i relation till produkten ska rapporteras till tillverkaren och berörd myndighet i medlemsstaten där användaren och/eller patienten befinner sig.

 901162 iEXAMINER PRO SW APP ANDROID

 IEXAMINER PRO ANDR

80032177 A, Revisionsdatum: 2026-06

 Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA
hillrom.com

Auktoriserad australisk sponsor
Welch Allyn Australia Pty. Limited
1 Baxter Drive
Old Toongabbie NSW 2146
Australia

Welch Allyn Inc. är ett dotterbolag till Hill-Rom Holdings Inc.
Tillverkad i USA

Innehållsförteckning

Beskrivning av enheten1

Avsedd användning1

Kontraindikationer.....2

Prestandaegenskaper2

Symboldefinitioner3

Varningar och försiktighetsåtgärder4

Övriga risker5

Enhets- och patientdata samt säkerhet6

Första användningen7

 Riktlinjer för val av smarttelefon och fodral9

 Testa enheten 10

Använda appfunktionerna..... 12

Android-anvisningar 13

 Skärmelement (Android) 13

 Ändra inställningar (Android) 14

 Autentisering (Android) 15

 Ange lösenord (Android)..... 15

 Återställa lösenord (Android) 16

 Logga in (Android)..... 17

 Förfallna undersökningar (Android) 18

 Undersökningar som snart förfaller (Android) .. 24

 Lägga till en undersökning (Android) 25

 Ta bilder (Android) 26

 Välj bilder (Android) 29

 Visa en vald bild (Android)..... 30

 Spara en undersökning (Android) 32

 Uppdatera en sparad undersökning (Android).. 33

 Dela en undersökning (Android)..... 35

 Dela en bild (Android) 37

Radera en undersökning (Android)..... 39

Kassera en undersökning (Android)..... 40

Rengöring 41

Säker avfallshantering 42

EMC-överensstämmelse 42

Förvaring och transport..... 43

Tillbehör..... 43

Kompatibla enheter 43

Garanti..... 44

Beskrivning av enheten

iExaminer-appen motsvarar **Welch Allyn iExaminer Pro**-appen.

iExaminer System med **MacroView Plus** består av **MacroView Plus**, **SmartBracket**, **SmartClip**, **iExaminer**-appen och en smarttelefon med fodral som uppfyller "[Riktlinjer för val av smarttelefon och fodral](#)".

iExaminer System med **PanOptic Plus** består av **PanOptic Plus**, **SmartBracket**, **SmartClip**, **iExaminer**-appen och en smarttelefon med fodral som uppfyller "[Riktlinjer för val av smarttelefon och fodral](#)".

Avsedd användning

iExaminer-appen med aktuella Welch Allyn-enheter är avsedd att användas av läkare och sjukvårdspersonal för att ta och skicka bilder av pediatrika och vuxna patienter.

iExaminer-systemet med **MacroView Plus** är avsett att användas av läkare och sjukvårdspersonal för att ta och skicka bilder av ytterörat, hörselgången och trumhinnan på pediatrika och vuxna patienter.

iExaminer System med **PanOptic Plus** är avsett att användas av läkare och sjukvårdspersonal för att ta och skicka bilder av ögat på pediatrika och vuxna patienter.

De avsedda användningsmiljöerna för **iExaminer**-appen och **iExaminer**-systemet med **MacroView Plus** är professionella sjukvårdsinrättningar,

till exempel läkarmottagningar, sjukhus, specialistkliniker, akutvård, kliniker och utbildning i klinisk miljö.



ANM. Använd smarttelefonen endast i miljöer som överensstämmer med tillverkarens rekommendationer.

Kontraindikationer

Det finns inga kontraindikationer för **iExaminer**-appen. Se bruksanvisningen för aktuell Welch Allyn-enhet.

iExaminer-systemet med **MacroView** Plus är inte avsett att användas för att undersöka ögat.

Prestandaegenskaper

Se bruksanvisningen för aktuell Welch Allyn-enhet.

Symboldefinitioner

Om du vill ha information om ursprunget för de här symbolerna kan du gå till symbolordlistan för Welch Allyn: welchallyn.com/symbolsglossary.



VARNING Varningar i den här bruksanvisningen anger förhållanden eller tillvägagångssätt som kan leda till sjukdom, kroppsskador eller dödsfall. Varningssymboler visas med grå bakgrund i svartvita dokument.



FÖRSIKTIGHET Texter med denna symbol i manualen anger förhållanden eller förfaranden som kan orsaka skada på utrustningen eller annan egendom eller förlust av data.



ANM. Ger ett förtydligande om en instruktion eller användbar information om en funktion eller ett beteende.



Läs bruksanvisningen. En kopia av bruksanvisningen finns på den här webbplatsen. Du kan beställa en tryckt kopia av bruksanvisningen från Hillrom. Den levereras inom sju kalenderdagar.

R_x ONLY

Endast recept eller "För användning av eller på ordination av en legitimerad läkare"



Beställningsnummer



Produktidentifikation



GTIN-artikelnnummer



Tillverkare

Varningar och försiktighetsåtgärder

-  **WARNING** Använd alltid **iExaminer**-appen när du ska skicka bilder eller patientfiler. Skicka inte patientbilder från kamerarullen för att förhindra att patientbilder associeras felaktigt. Begränsa användningen av bilder från kamerarullen till utbildning och icke-klinisk användning. Se [Enhets- och patientdata samt säkerhet](#).
-  **WARNING** Utrustningen/systemet är endast avsett att användas av sjukvårdspersonal. Utrustningen/systemet kan orsaka radiostörningar eller orsaka avbrott i driften av utrustning i närheten. Det kan hända att du måste vidta vissa korrigerande åtgärder, som att rikta om eller flytta enheten eller avskärma platsen.
-  **WARNING** Risk för patientskada – magnetiskt fält. Var försiktig när du använder en smarttelefon i närheten av implanterade enheter, såsom, men inte begränsade till, skallimplantat, justerbara CSF-shuntar och pacemakrar.
-  **FÖRSIKTIGHET** Utvärdera bilderna på **Welch Allyn iExaminer** i lämpligt ljus. Bildutvärderingen har inte testats i förhållanden med svagt ljus.
-  **FÖRSIKTIGHET** För att säkerställa att systemet ger bilder av tillräcklig kvalitet ska du testa det monterade systemet. Se [Testa enheten](#).
-  **ANM.** Mer information om varningar och försiktighetsåtgärder finns i bruksanvisningen för aktuell Welch Allyn-enhet.
-  **ANM.** Se aktuell bruksanvisning för Welch Allyn-enheter för information om ljusrelaterade risker som är förknippade med din enhet.

Övriga risker

Den här produkten uppfyller relevanta standarder för elektromagnetisk interferens, mekanisk säkerhet, prestanda och biokompatibilitet. Produkten kan dock inte helt eliminera risken för patient- eller användarskador av följande typ och orsak:

- person- eller enhetsskador i samband med elektromagnetiska risker,
- skador på grund av mekaniska risker,
- skador orsakade av otillgänglig enhet, funktion eller parameter,
- skador till följd av felaktig användning, till exempel otillräcklig rengöring, eller
- skador från exponering för biologiska utlösare som kan resultera i en allvarlig systemisk allergisk reaktion.

Enhets- och patientdata samt säkerhet

Welch Allyn rekommenderar att du aktiverar säkerhet på enhetsnivå. Användarna ansvarar för smarttelefonens säkerhet.

Med **iExaminer**-appen kan användaren dela patientdata via e-post och molnbaserad lagring. När patientdata delas via e-post eller molnbaserad lagring är det viktigt att användaren endast delar data med andra behöriga användare i enlighet med HIPAA-reglerna. Det är användarens eget ansvar att skydda patientdata. Användarna måste verifiera patientens identitet innan de skickar patientjournaler.

För att säkert kunna dela patientdata via e-post måste användaren se till att e-postprogrammet är konfigurerat för säker kommunikation med e-postservern med TLS (Transport Layer Security). TLS (Transport Layer Security) är kryptografiska protokoll som har utformats för att ge kommunikationssäkerhet över ett datornätverk. TLS syftar främst till att tillhandahålla sekretess och dataintegritet mellan två eller flera kommunicerande datorprogram.

När användaren konfigurerar ett e-postkonto (t.ex. IMAP eller POP) måste han eller hon välja en säkerhetsmetod som använder TLS/SSL. **Android**-standardprogrammet för e-post (**Gmail**) är redan skyddat med TLS när det används med **Gmail**-standardservern.

När patientdata skickas till molnbaserad lagring är det viktigt att molnlagringsmetoden säkras med TLS. I **Android** skyddas **Google Drive** och **Google Photos** med TLS.

Första användningen

Besök hillrom.com för att se videor om **iExaminer Pro**.

Följande villkor eller åtgärder måste uppfyllas eller vidtas:

1. Välj en smarttelefon som uppfyller kriterierna i [Riktlinjer för val av smarttelefon och fodral](#).
2. Ladda ned **iExaminer**-appen från **Google Play** Butik.
3. Om du uppgraderar från en tidigare version som lagrade bilder följer du instruktionerna på skärmen.
4. Välj ett användningsläge.
 - Det kliniska läget ska användas på patienter. Undersökningsdata måste skickas från appen efter varje undersökning. Inga undersökningsdata sparas på mobiltelefonen.
 - Utbildningsläget är endast avsett för utbildning. Genom att välja det här läget kan övningsundersökningar sparas under en användardefinierad tidsperiod på 30 till 180 dagar. Därefter måste du radera data från appen. Inga individuellt identifierbara patientdata eller personuppgifter bör sparas i detta läge. Standardperioden för datalagring är 30 dagar för övningsundersökningar.
5. Godkänn villkoren.
6. Konfigurera appsäkerheten och smarttelefonens säkerhet. Läs igenom rekommendationerna för konfidentialitet. Se [Enhets- och patientdata samt säkerhet](#).

7. Information om den inledande konfigurationen finns i **MONTERINGSANVISNINGARNA TILL WELCH ALLYN IEXAMINER SMARTBRACKET (WELCH ALLYN IEXAMINER SMARTBRACKET ASSEMBLY INSTRUCTIONS)** (medföljer i förpackningen). Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för att sätta fast **SmartBracket**-tejpen och **SmartClip** på den släta, stadiga, plana baksidan av fodralet.
8. Fäst Welch Allyn-enheten vid **SmartBracket**.
9. Testa det monterade systemet med **iExaminer Resolution Test Card** (medföljer). Se [Testa enheten](#).
10. Se videor och annat utbildningsmaterial på hillrom.com för att utföra en undersökning.



ANM. **iExaminer** 3.3.x är kompatibel med **Android** 11.0 och senare.



ANM. Om du vill byta läge avinstallerar du och installerar om appen. Alla lagrade data tas bort när du avinstallerar appen.

Riktlinjer för val av smarttelefon och fodral

Fodral till smarttelefon

Fodralet ska ha en slät, plan yta som inte är av gummi (silikonfodral fungerar exempelvis inte) utan utskjutande delar. Vissa funktioner (t.ex. fingeravtryckssensor, andra kameror osv.) förhindrar installationen av **SmartClip**. Se **MONTERINGSANVISNINGARNA TILL WELCH ALLYN IEXAMINER SMARTBRACKET (WELCH ALLYN IEXAMINER SMARTBRACKET ASSEMBLY INSTRUCTIONS)** (medföljer i förpackningen).

Kriterier för smarttelefon

Använd en smarttelefon som uppfyller kriterierna nedan:

- Storlek: Den kombinerade smarttelefons- och fodralstorleken är mindre än 165 mm i längd, 85 mm i bredd och 13 mm i tjocklek.
- Vikt: Smarttelefonen och fodralet väger tillsammans mindre än 280 g.
- Optik: De flesta smarttelefonkameror med en upplösning på 8 MP eller högre fungerar. Information om hur du testat det monterade systemet finns i [Testa enheten](#).
- Skärm: En färgskärm som är $\geq 4,0$ tum (101 mm) stor.
- Maskinvara: ≥ 500 MB internt lagringsutrymme.
- Programvara: Har stöd för JPEG-bilder och är kompatibel med **Android** 11.0 och senare.
- El
 - o Strålningen från smarttelefonen måste uppfylla del 15 av avdelning 47 i Code of Federal Regulations (eller motsvarande).
 - o Smarttelefonens induktiva laddning måste vara Qi-certifierad (eller motsvarande).
 - o Smarttelefonens laddning måste överensstämma med IEC/UL 60950-1 (eller motsvarande).

Testa enheten

Öppna **iExaminer**-appen och utför följande:

1. Sätt fast ett handtag på huvudet. Om ett oftalmoskop används sätter du på handtaget och ställer in dioptrin på grön 8 med stor ljuspunkt och utan filter.
2. Fäst huvudet på **SmartBracket**. Huvudet kan fästas i 1 av 4 riktningar.
3. Placera **iExaminer** Resolution-testkortet (medföljer i förpackningen) på en plan yta.
4. På undersökningsskärmen trycker du på Add image (Lägg till bild).



ANM. I utbildningsläget trycker du på **+** för att starta en undersökning.

5. Inspelningen börjar. Inspelningen avslutas efter 30 sekunder. Tryck på **●** för att starta om inspelningen efter behov för att slutföra stegen.
6. Rikta skopet mot en yta i närheten för att kontrollera att cirkeln på skärmen på din smartphone är en hel cirkel.



ANM. Om det inte är en hel cirkel kontrollerar du att förstoringen är inställd på 1,0x och att bländaröppningen på den primära objektivlinsen är inriktad mot **SmartBracket**. Om den inte är inriktad följer du anvisningarna för **SmartClip**-borttagning i **STARTHANDBOKEN TILL WELCH ALLYN IEXAMINER SMARTBRACKET**.

7. Rikta in cirkeln på **iExaminer** Resolution-testkortet mot kanten på det visningsbara området. Flytta skopet närmare eller längre bort från kortet efter behov. Ändra inte förstoringen.



ANM. Om inte autofokusen fungerar trycker du på skärmen på mittmålet. Autofokus återställs.





ANM. Välj lämplig målcirkel. Det finns ett för oftalmoskop och ett för otoskop.


8. Välj den bästa bilden. Nyp ihop för att zooma in på den tagna bilden av upplösningmålen.
9. Jämför alla 5 målen och kontrollera att bilderna har 3 synliga linjer. Om inte, upprepa testet.

Godkänt
(3 synliga linjer)

Godkänt
(3 synliga linjer)

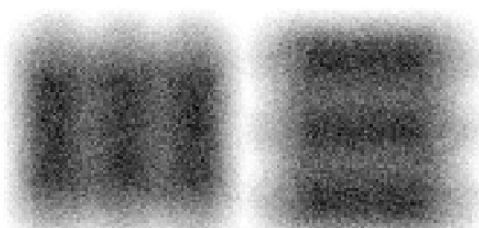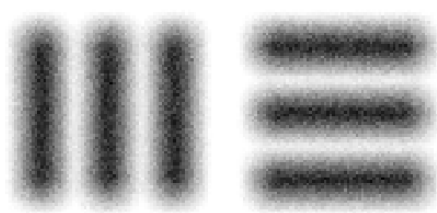

Underkänt*

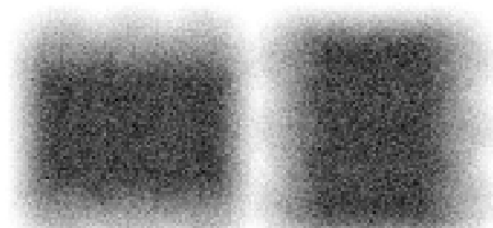

10. Påbörja patientundersökningen. Se teknikhandboken (medföljer i förpackningen) eller bruksanvisningen (finns i appen och på hillrom.com/getstarted).

*Kontakta Hillrom tekniska support eller besök hillrom.com om du behöver hjälp.



Använda appfunktionerna

Använd länkarna nedan för att gå till en åtgärd eller läsa de fullständiga instruktionerna för operativsystemet för din enhet.

Utbildningsläge	Kliniskt läge
Android	Android
Ändra inställningar (Android)	Ändra inställningar (Android)
Ange lösenord (Android)	Inte tillgängligt
Återställa lösenord (Android)	Inte tillgängligt
Logga in (Android)	Inte tillgängligt
Visa en förfallen undersökning (Android)	Inte tillgängligt
Radera en undersökning (Android)	Inte tillgängligt
Visa undersökningar som snart förfaller (Android)	Inte tillgängligt
Lägga till en undersökning (Android)	Starta en ny undersökning (Android)
Ta bilder (Android)	Ta bilder (Android)
Välj bilder (Android)	Välj bilder (Android)
Visa en vald bild (Android)	Visa en vald bild (Android)
Filtrera, flytta och radera bilder (Android)	Filtrera, flytta och radera bilder (Android)
Dela en bild (Android)	Dela en bild (Android)
Spara en undersökning (Android)	Inte tillgängligt
Uppdatera en sparad undersökning (Android)	Inte tillgängligt
Dela en undersökning (Android)	Dela en undersökning (Android)
Radera en undersökning (Android)	Kassera en undersökning (Android)

Gå till [Android-anvisningar](#) för att få information om hur appen används.




Android-anvisningar

 **ANM.** Bilderna visas i illustrativt syfte.

 **ANM.** Det kliniska läget öppnas med skärmen Exam (Undersökning).

Skärmelement (Android)

Passar: Utbildningsläge, kliniskt läge

Ikon	Definition
	Dela
	Ta bort
	Filter
	Lägg till
	Tillbaka
	Klar
	Flytta


Gå till *Använda listan med appfunktioner*

Ändra inställningar (Android)


Passar: Utbildningsläge, kliniskt läge

Ändra inställningar som bildupplösning eller datalagringsperiod. Vissa inställningar kanske endast är tillgängliga i ett specifikt läge.

1. Tryck på menyikonen i det övre högra hörnet i appen

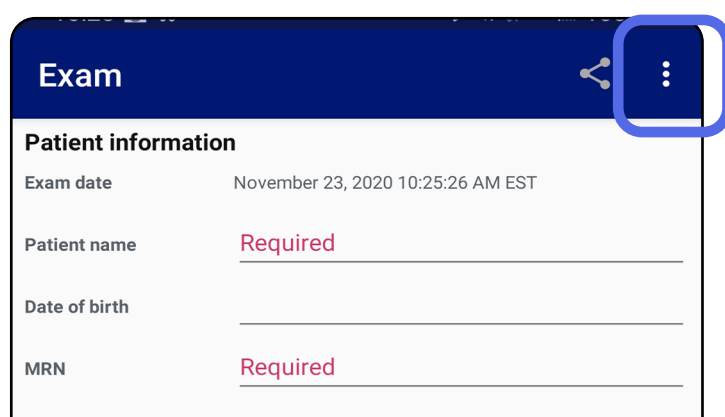

2. Tryck på **Settings** (Inställningar)
3. Ändra inställningsalternativen. [Testa enheten](#) igen om du ändrar bildupplösningen.
4. Tryck på ← i det övre vänstra hörnet för att spara inställningarna.

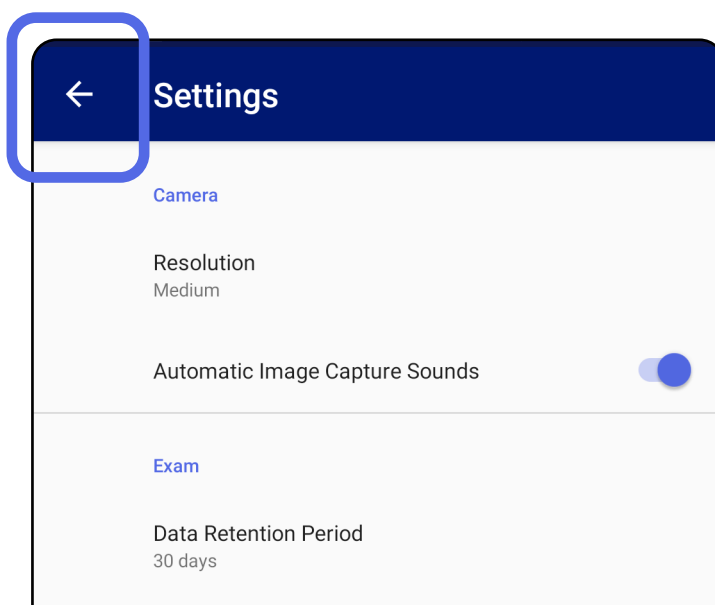

Gå till *Använda listan med appfunktioner*

Autentisering (Android)

Passar: Utbildningsläge

På skärmen Authentication (Autentisering) kan du:

- [Ange lösenord \(Android\)](#)
- [Återställa lösenord \(Android\)](#)
- [Logga in \(Android\)](#)

Ange lösenord (Android)

Passar: Utbildningsläge

1. Ange ett lösenord som uppfyller valideringskriterierna.
2. Ange det nya lösenordet två gånger på skärmen Authentication (Autentisering).
3. Tryck på **Set** (Ställ in).

Authentication

Enter a new password.

Password

Confirm password

SET

Gå till *Använda listan med appfunktioner*

Återställa lösenord (Android)

Passar: Utbildningsläge

1. Tryck på **Reset** (Återställ) på skärmen Authentication (Autentisering) för att återställa lösenordet.
2. Ange ett nytt lösenord två gånger.
3. Tryck på **Reset** (Återställ) för att bekräfta återställningen av lösenordet. Den här åtgärden kan inte ångras.



ANM. När du återställer lösenordet tas alla befintliga undersökningar bort från appen.

Gå till *Använda listan med appfunktioner*

Logga in (Android)

Passar: Utbildningsläge

1. Öppna appen.
2. Ange ditt lösenord på skärmen Authentication (Autentisering).
3. Tryck på **Login** (Logga in).

Authentication

Enter your password.

Password


RESET LOG IN

Förfallna undersökningar (Android)


Passar: Utbildningsläge

När appen öppnas i utbildningsläge och det finns förfallna undersökningar måste de förfallna undersökningarna raderas innan du kan fortsätta använda appen. En varning visas om några undersökningar har förfallit.

- 1. Tryck på OK för att bekräfta varningen.

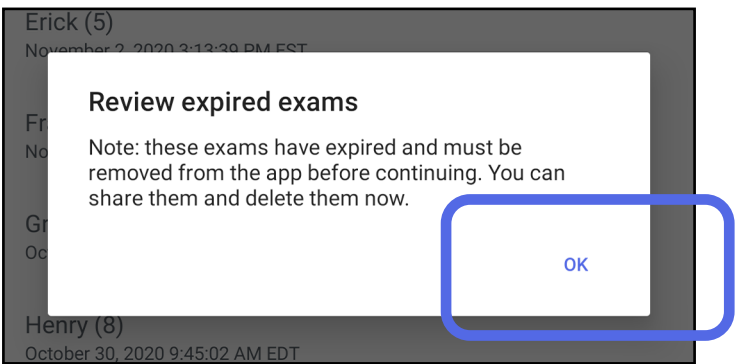

- 2. Granska listan över förfallna undersökningar.

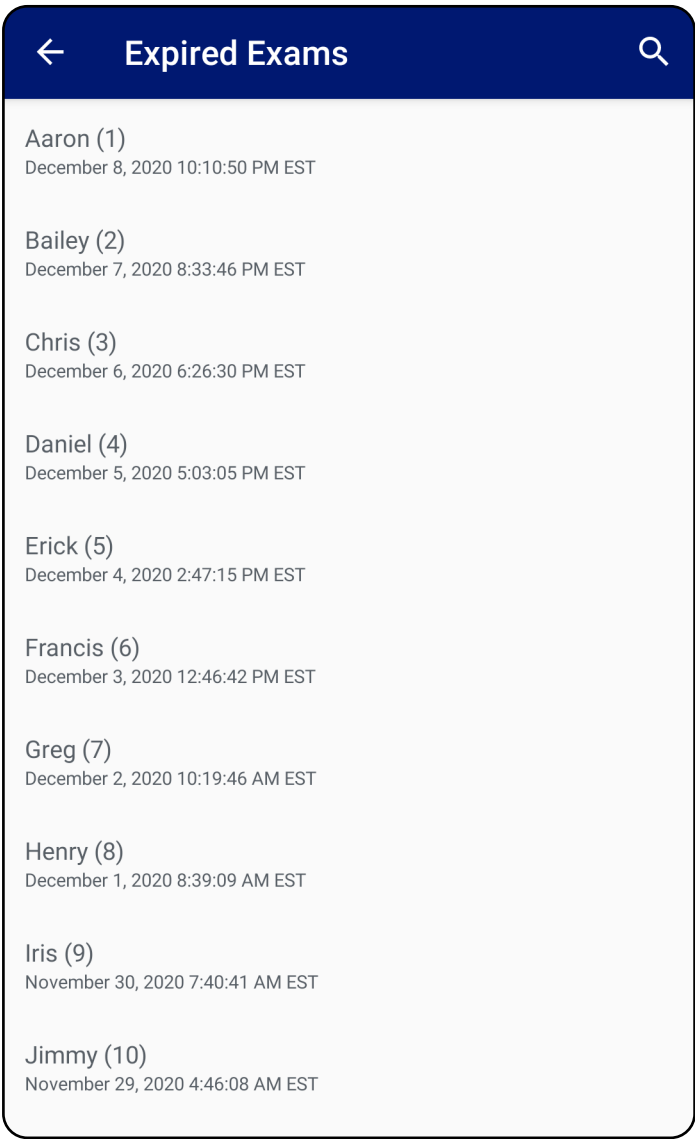

- 3. [Visa en förfallen undersökning \(Android\)](#) där du kan dela eller radera undersökningen och dela bilderna i en undersökning eller [Radera en undersökning \(Android\)](#).


Gå till *Använda listan med appfunktioner*

Visa en förfallen undersökning (Android)

Passar: Utbildningsläge

Tryck på en förfallen undersökning i listan för att visa den. Den förfallna undersökningen är skrivskyddad och måste raderas innan du startar en ny undersökning. Innan du raderar den förfallna undersökningen kan du:

- Tryck på en bild för att [Visa en bild i en förfallen undersökning \(Android\)](#).
- Tryck på  för att [Dela en undersökning \(Android\)](#).

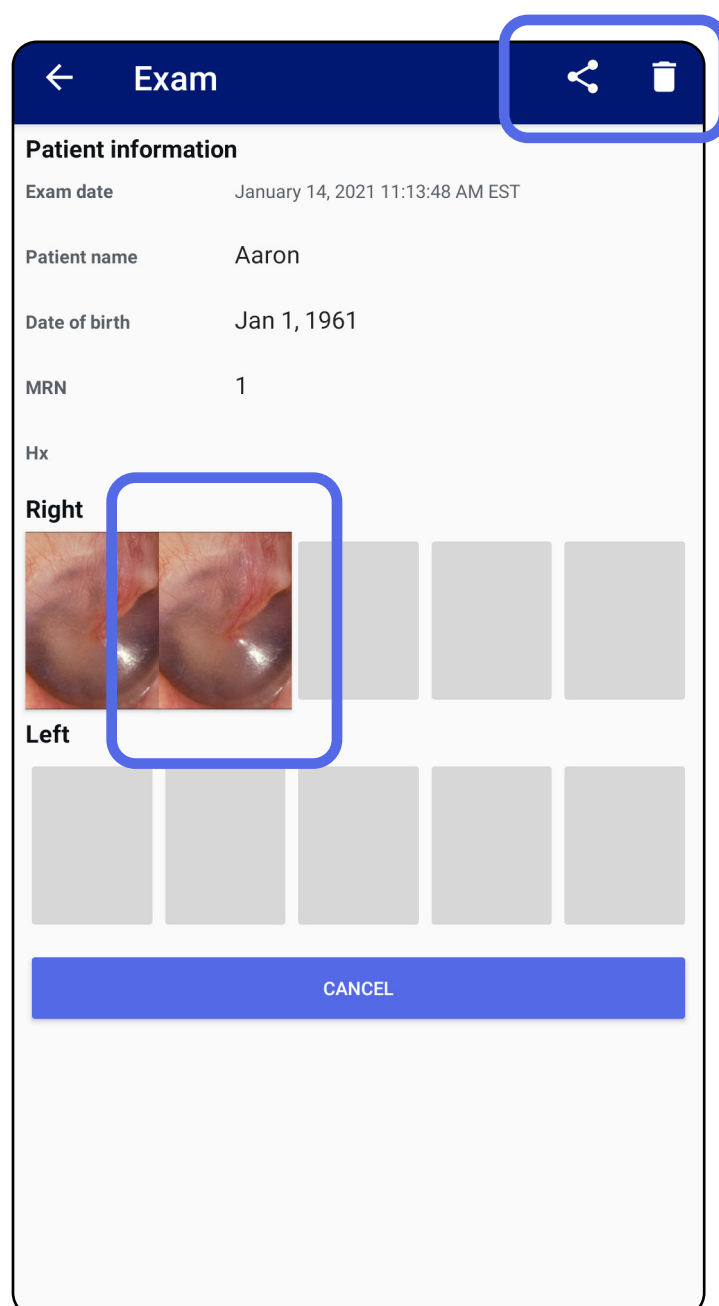

- Se [Radera en undersökning \(Android\)](#).


Gå till *Använda listan med appfunktioner*

Visa en bild i en förfallen undersökning (Android)

Passar: Utbildningsläge

Tryck på en bild för att öppna den på skärmen
Expired Exam (Förfallen undersökning).

- Tryck på  för att [tillämpa ett filter på en bild \(Android\)](#) i en förfallen undersökning.
- Tryck på  för att [Dela en bild \(Android\)](#) i en förfallen undersökning.

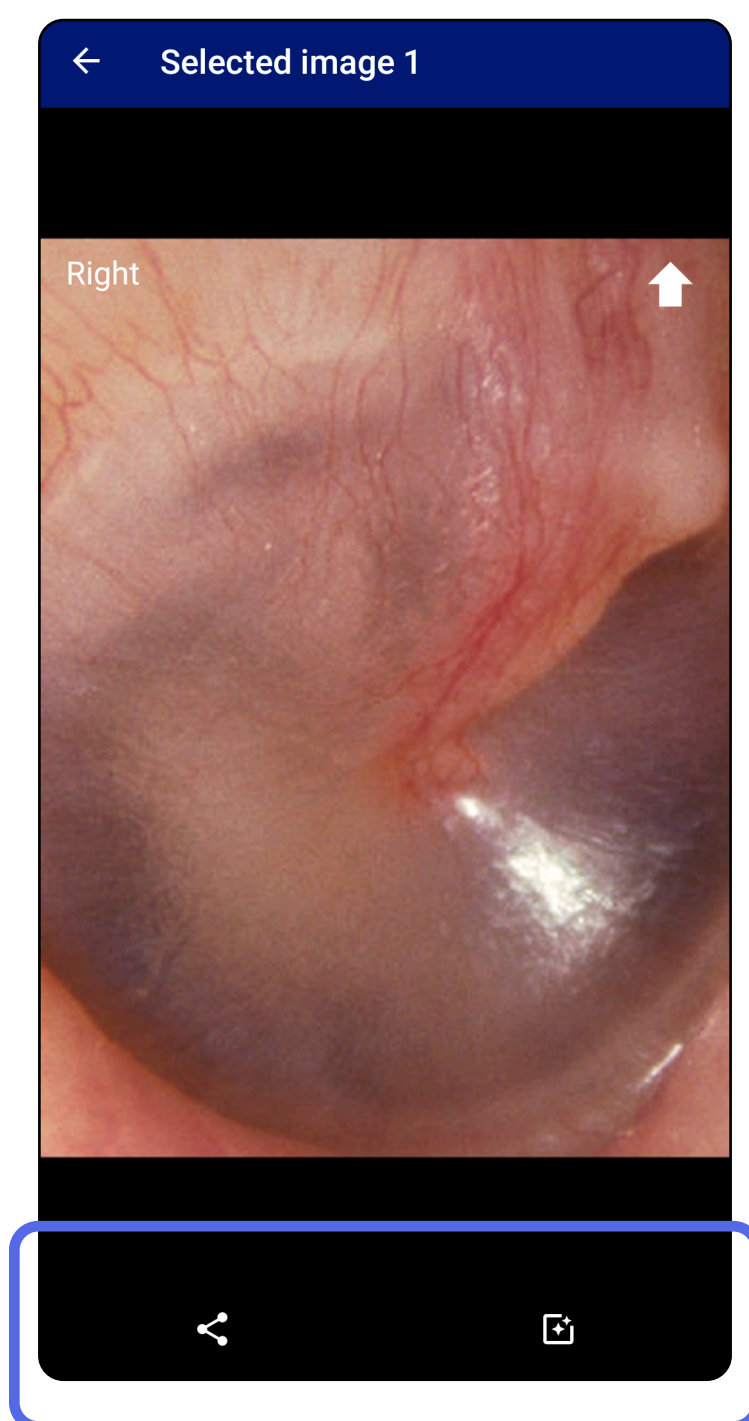


Gå till *Använda listan med appfunktioner*

Radera en undersökning (Android)


Passar: Utbildningsläge

Så här raderar du alla förfallna undersökningar:

- 1. Tryck på ←.

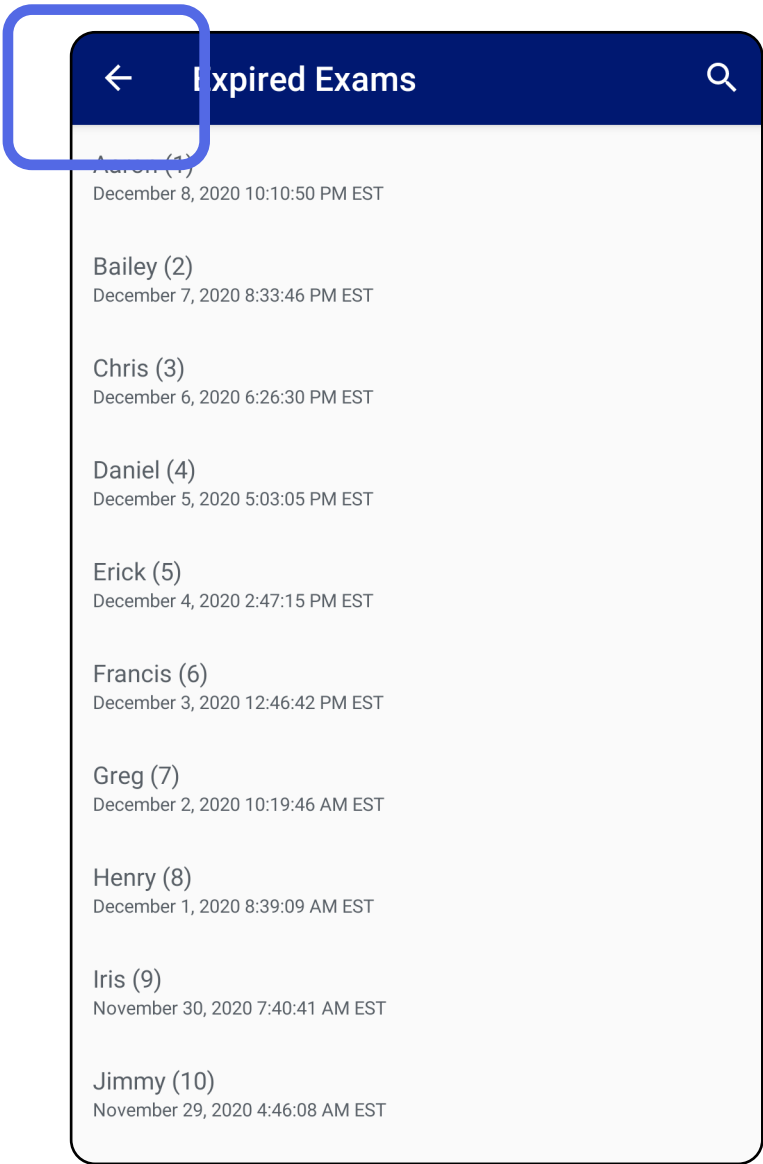


- 2. Tryck på **OK** för att bekräfta i popup-rutan.

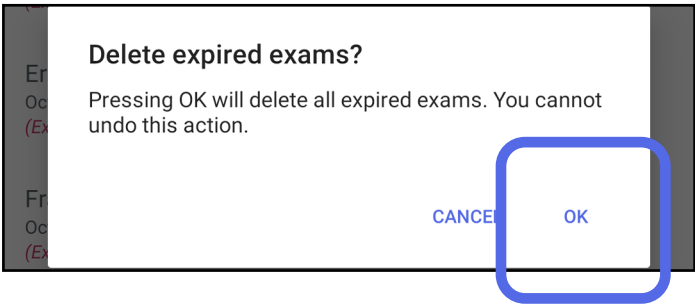

Det finns två alternativ för att radera en förfallen undersökning.


Alternativ 1: Svep för att radera

Svep åt vänster eller höger på namnet för den förfallna undersökningen.

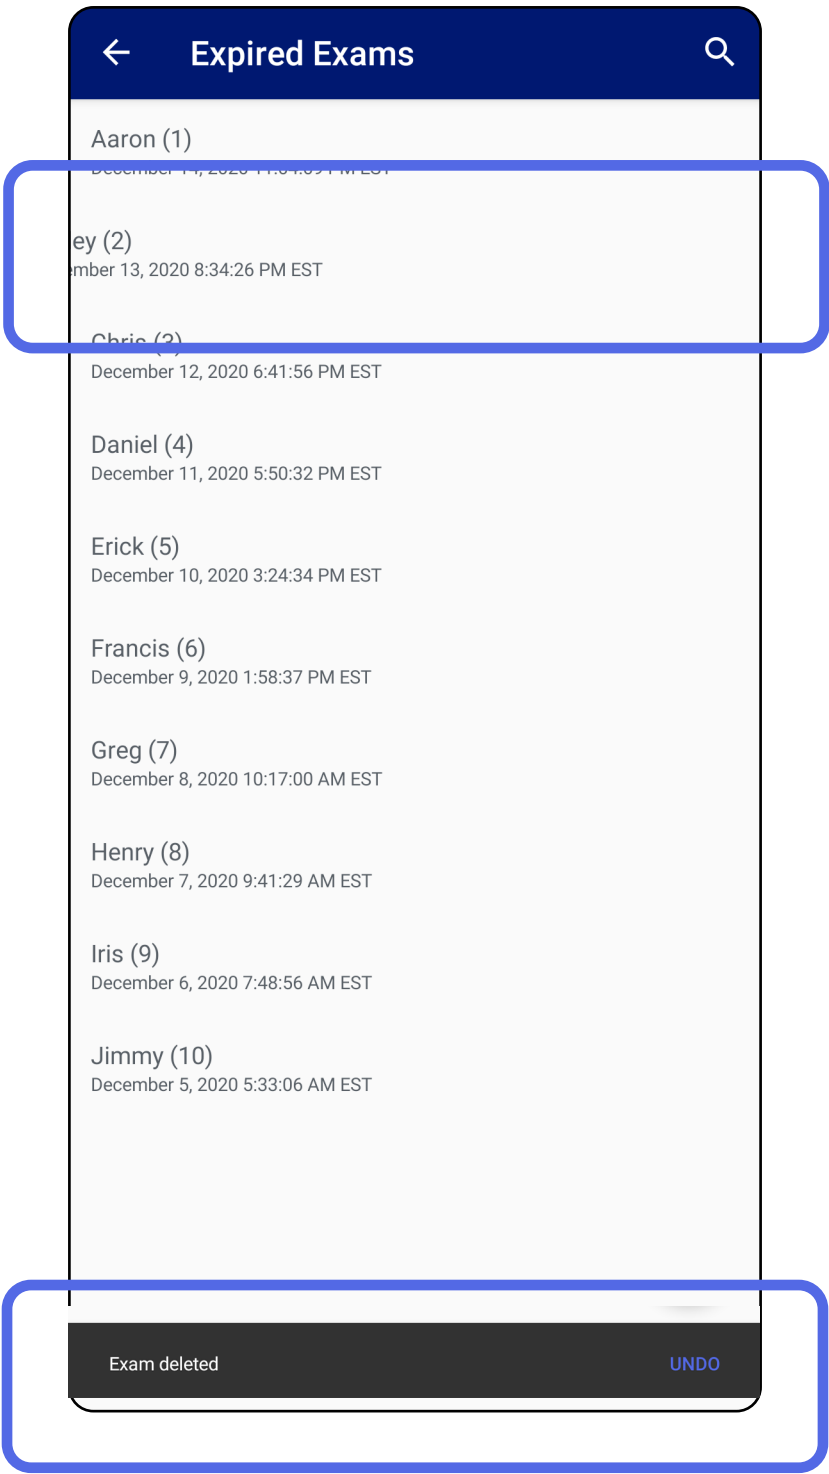

Tryck på **UNDO** (Ångra) inom 15 sekunder i popup-rutan för att ångra borttagningen.

Alternativ 2: Visa den förfallna undersökningen och tryck sedan på  .

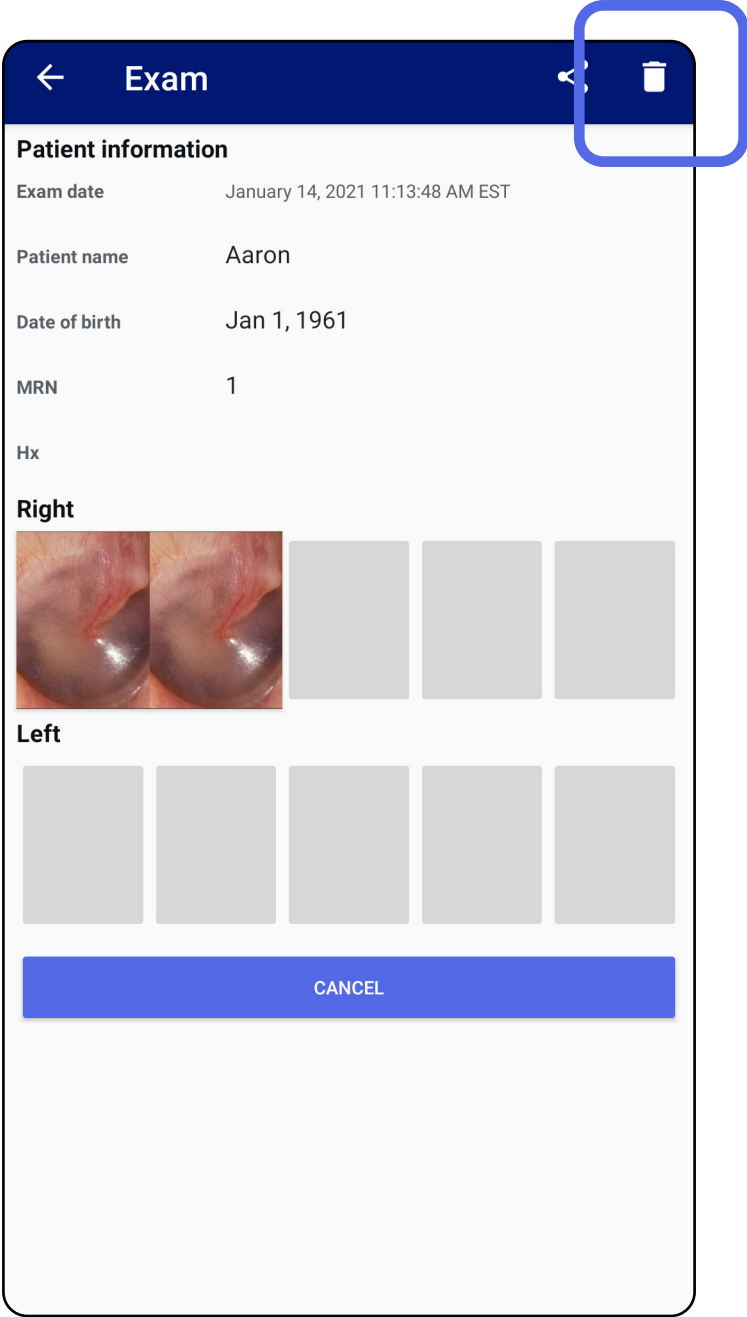


Undersökningar som snart förfaller (Android)

Passar: Utbildningsläge

När det finns undersökningar som snart förfaller visas dialogrutan "Undersökningar som snart förfaller".


Tryck på **OK** för att granska undersökningar som snart förfaller.

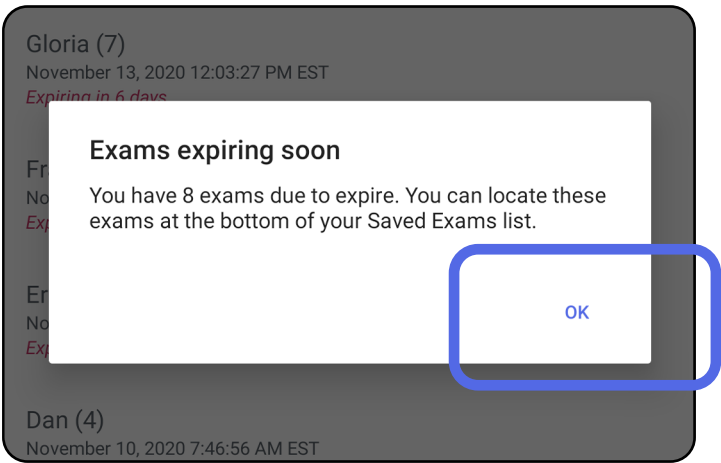

Visa undersökningar som snart förfaller (Android)

Passar: Utbildningsläge

Ingen åtgärd krävs förrän en undersökning förfaller.

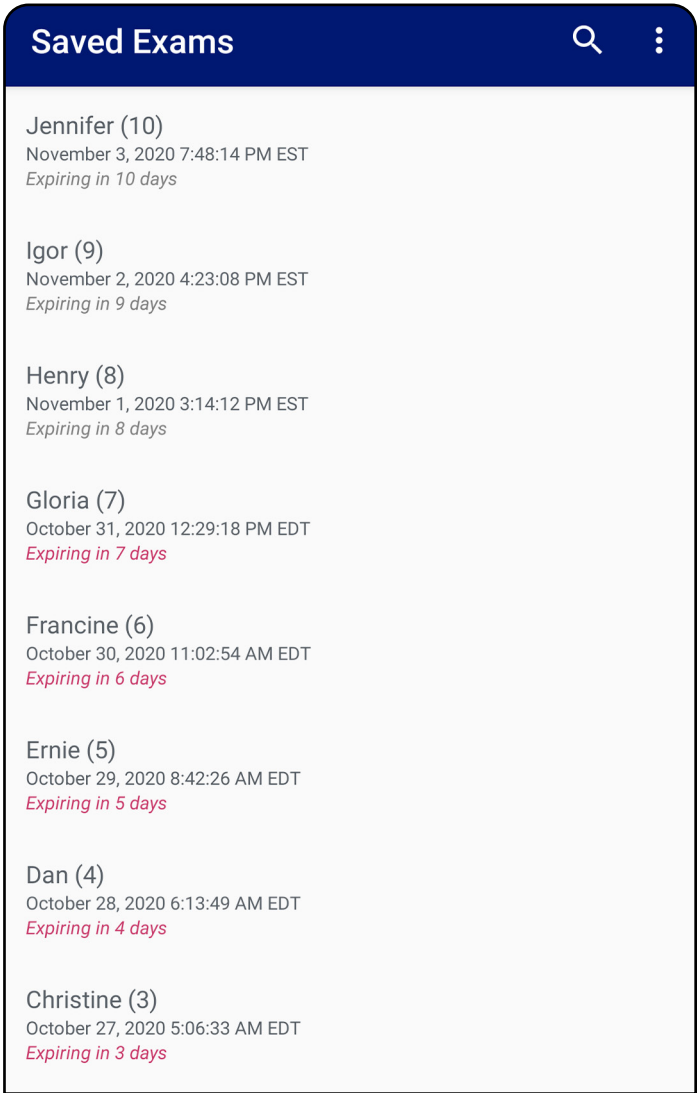


Gå till *Använda listan med appfunktioner*

Lägga till en undersökning (Android)

Passar: Utbildningsläge


- 1. Tryck på + för att lägga till en ny undersökning.
- 2. Se [Ta bilder \(Android\)](#).

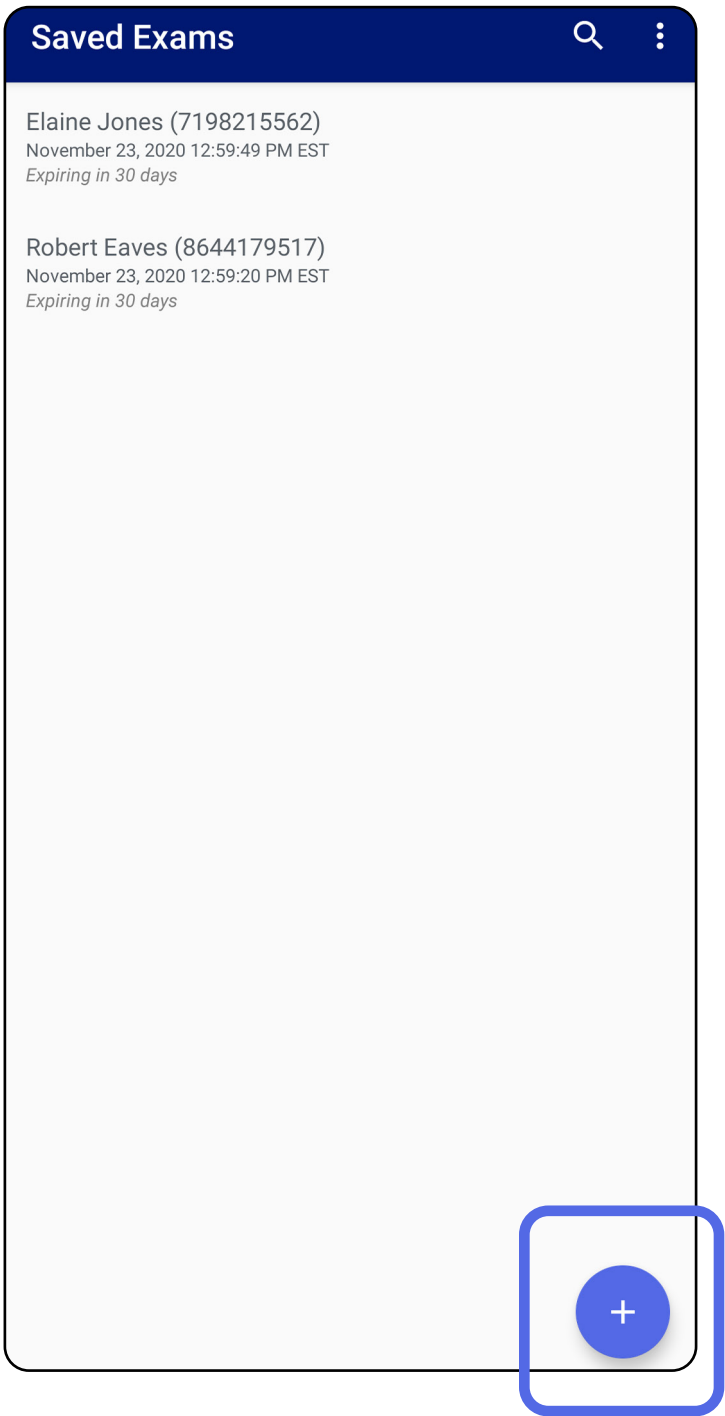


Ta bilder (Android)

Passar: Utbildningsläge, kliniskt läge


1. Placera enheten framför den valda sidan. Se videor och annat utbildningsmaterial på hillrom.com för att utföra en undersökning.
2. Tryck på **Add image** (Lägg till bild) för att ta bilder för höger eller vänster sida.

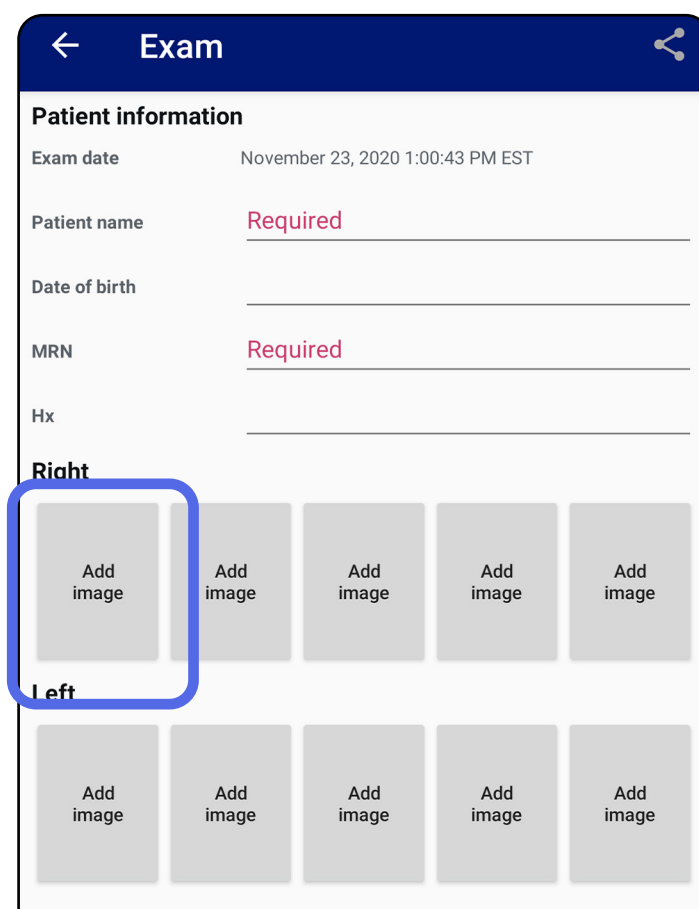

3. Om det finns en tidigare inspelning av samma sida väljer du ett alternativ på popup-menyn för att starta en **New recording** (Ny inspelning) eller spara bilderna från en **Previous recording** (Tidigare inspelning). Se [Välj bilder \(Android\)](#).

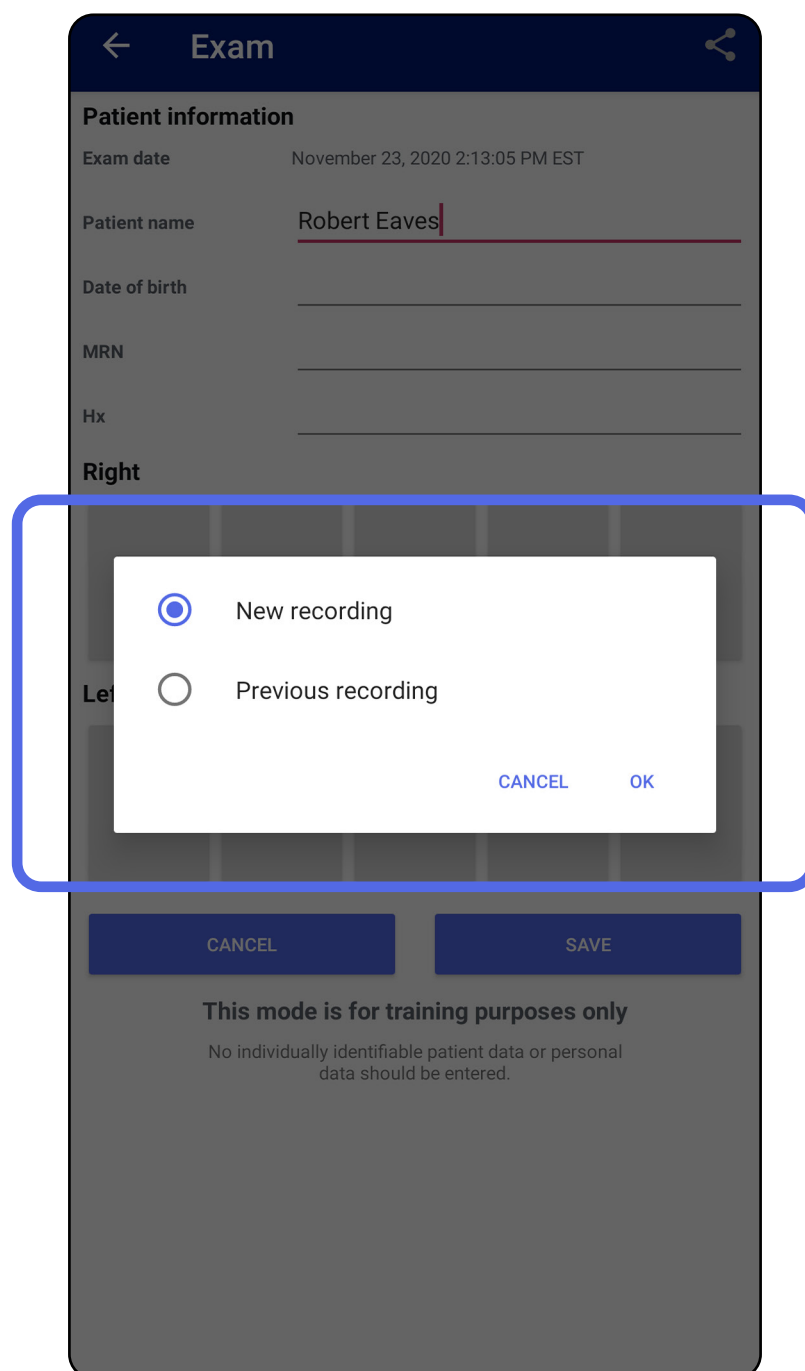

Om det inte finns någon tidigare inspelning av samma sida startas och stoppas inspelningen automatiskt. Se [Välj bilder \(Android\)](#).

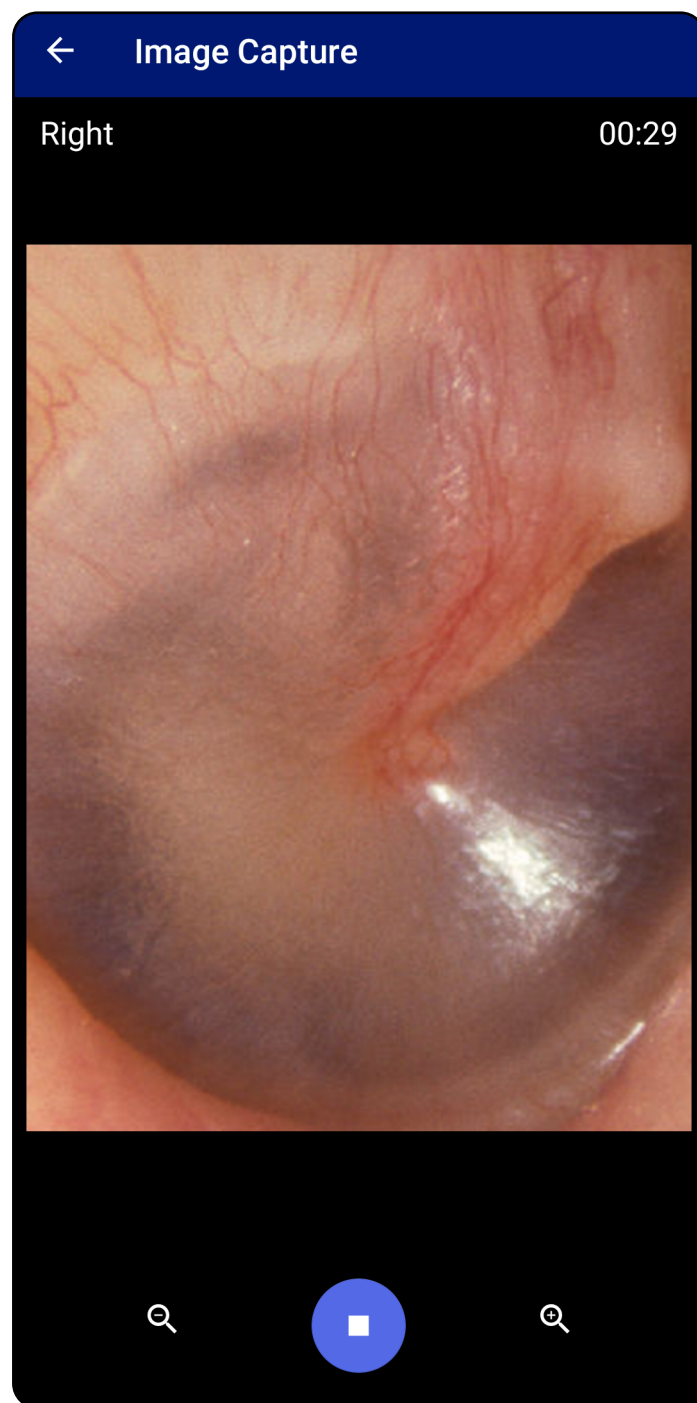

Välj bilder (Android)

Passar: Utbildningsläge, kliniskt läge


1. Välj de bilder som du vill behålla med hjälp av videospelarkontrollerna längst ned. Använd skjutreglaget för att hitta den bild du vill behålla. Använd reglagen för bakåt, uppspelning/paus och framåt för att flytta markeringen en bild i taget.
2. Tryck på **+** för varje bild som du vill behålla.
3. Tryck på **✓** i det övre högra hörnet.



ANM. Högst fem bilder per sida kan behållas i en undersökning.



ANM. Pilen i det övre högra hörnet av bilden anger vilken riktning som är uppåt på den tagna bilden.

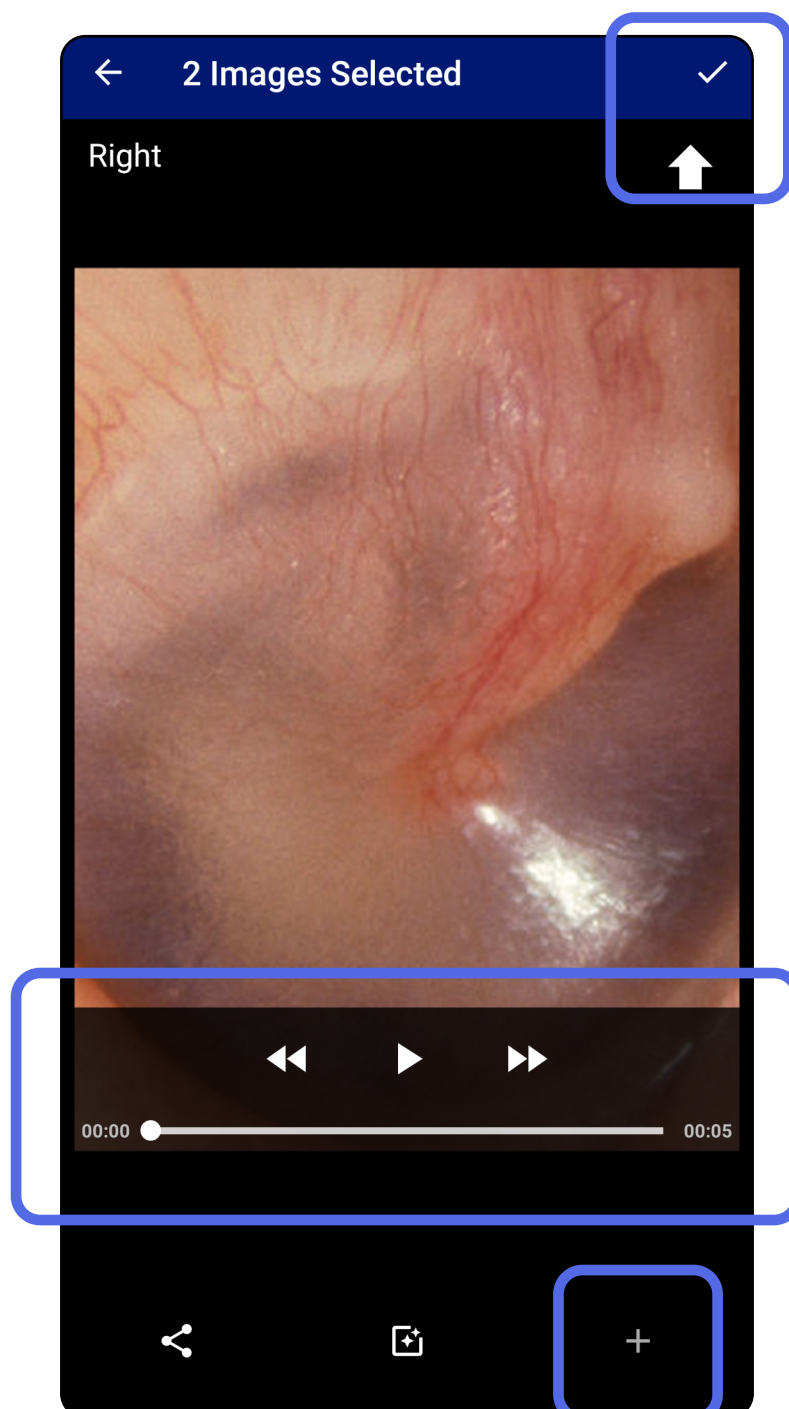

Gå till *Använda listan med appfunktioner*


Visa en vald bild (Android)

Passar: Utbildningsläge, kliniskt läge

1. Tryck på en bild på skärmen Exam (Undersökning).
2. På skärmen Selected image (Vald bild) sveper du åt vänster eller höger för att bläddra igenom alla bilder för båda sidorna.



ANM. Pilen i det övre högra hörnet av bilden anger vilken riktning som är uppåt på den tagna bilden.

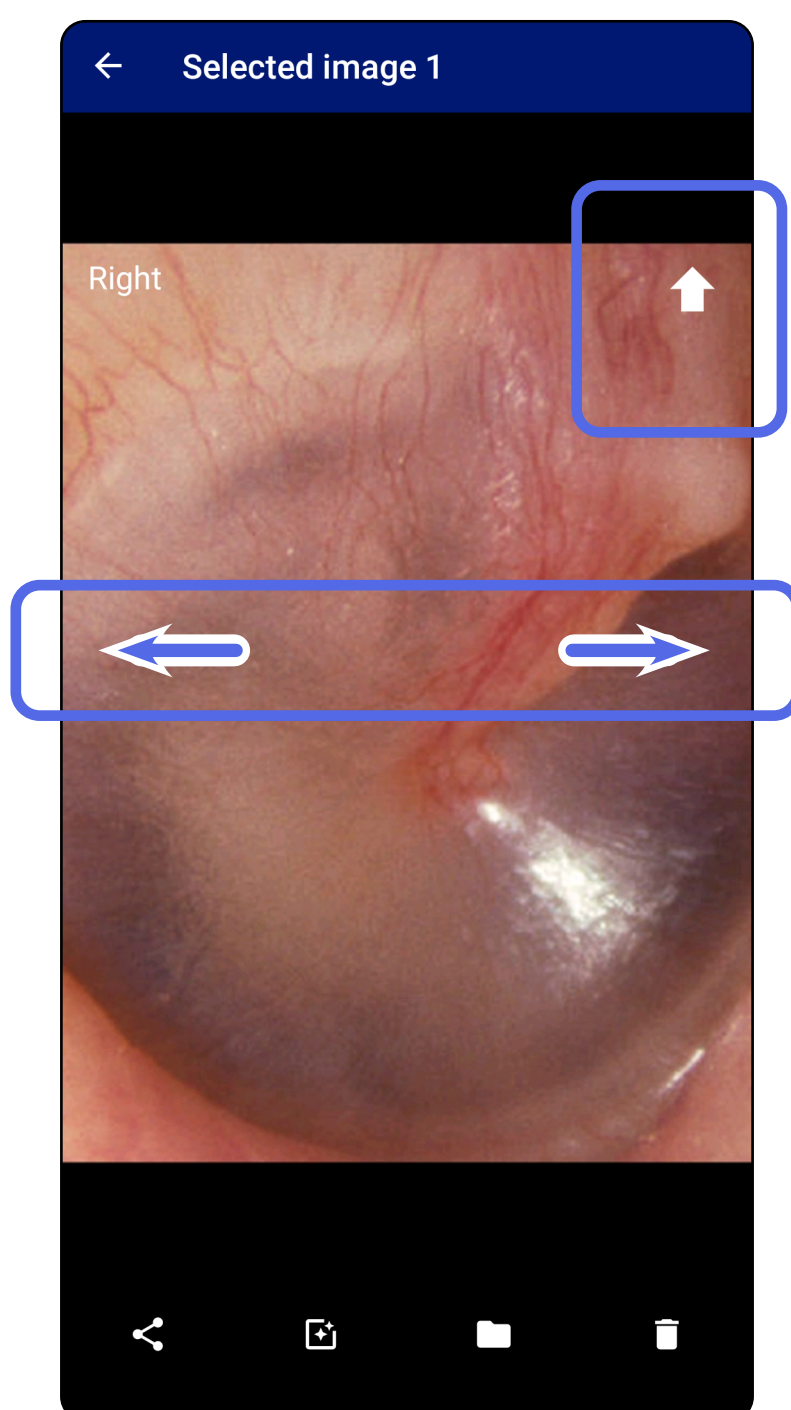


Gå till *Använda listan med appfunktioner*

Filtrera, flytta och radera bilder (Android)

Passar: Utbildningsläge, kliniskt läge

Tryck på en bild för att öppna den på skärmen Exam (Undersökning).

- Tryck på  för att tillämpa ett filter. Filter tillämpas endast på den aktuella bilden och när den bilden delas. De ursprungliga ofiltrerade bilderna lagras.
- Tryck på  och sedan på OK i popup-menyn för att flytta bilden till den andra sidan (*inte tillgängligt för förfallna undersökningar*). Den här funktionen är användbar om du valde fel sida när du startade bildtagningen.
- Tryck på  för att radera bilden och bekräfta sedan borttagningen (*inte tillgängligt för förfallna undersökningar*).

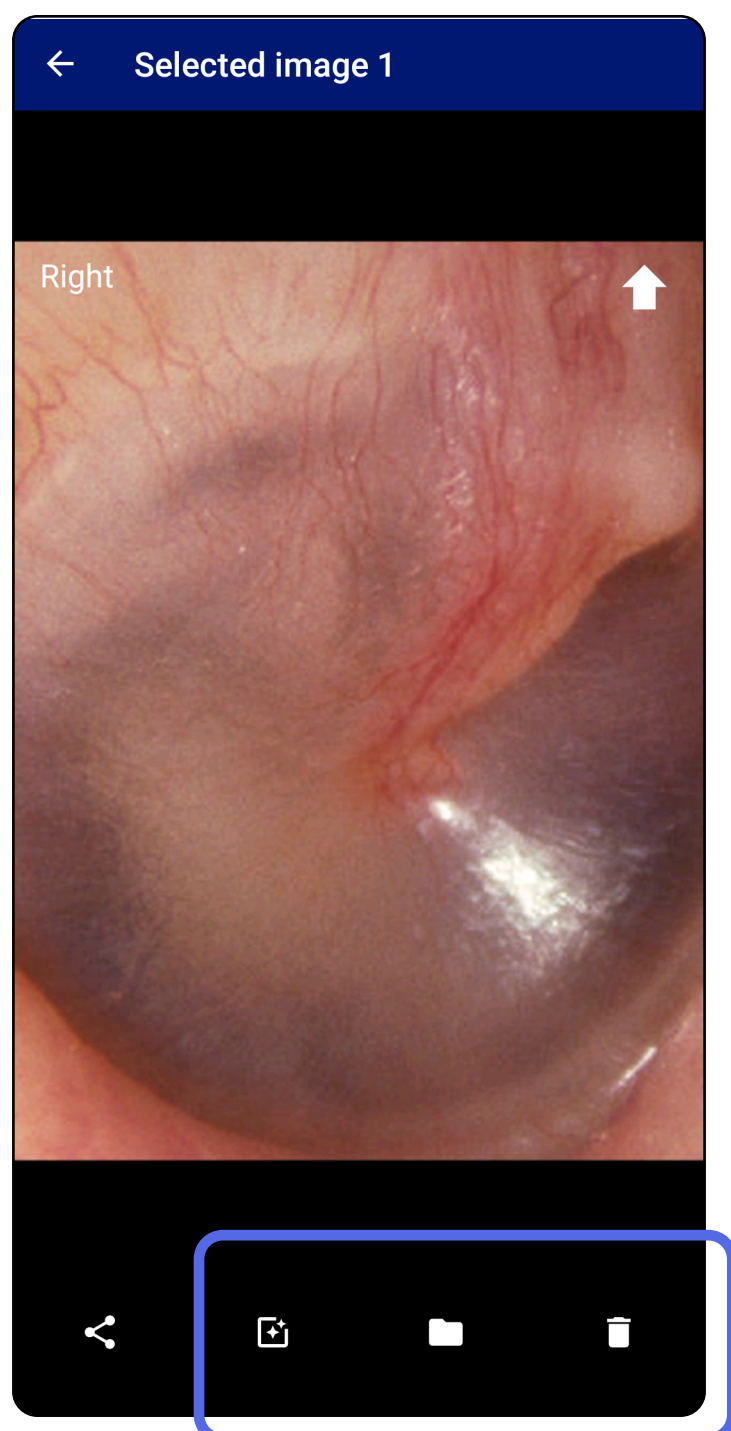

Gå till *Använda listan med appfunktioner*

Spara en undersökning (Android)

Passar: Utbildningsläge

- 1. Lägg till patientuppgifter.
- 2. Tryck på **Save** (Spara).

 **ANM.** Bilder krävs inte för att spara en undersökning. Patientuppgifter kan läggas till antingen före eller efter att bilder har valts.

 **ANM.** En undersökning går att spara först när de obligatoriska uppgifterna har angetts.

←

Exam

↗

🗑

Patient information

Exam date

January 13, 2021 1:51:32 AM EST

Patient name

Andy

Date of birth

Jan 1, 1961


MRN

1

Hx

Hx1

Right



Add image

Add image

Add image

Left

Add image

Add image

Add image

Add image

Add image

CANCEL

SAVE


This mode is for training purposes only

No individually identifiable patient data or personal data should be entered.

Uppdatera en sparad undersökning (Android)

Passar: Utbildningsläge

- 1. Om du vill redigera undersökningen klickar du på önskat undersökningsnamn för att öppna undersökningen.

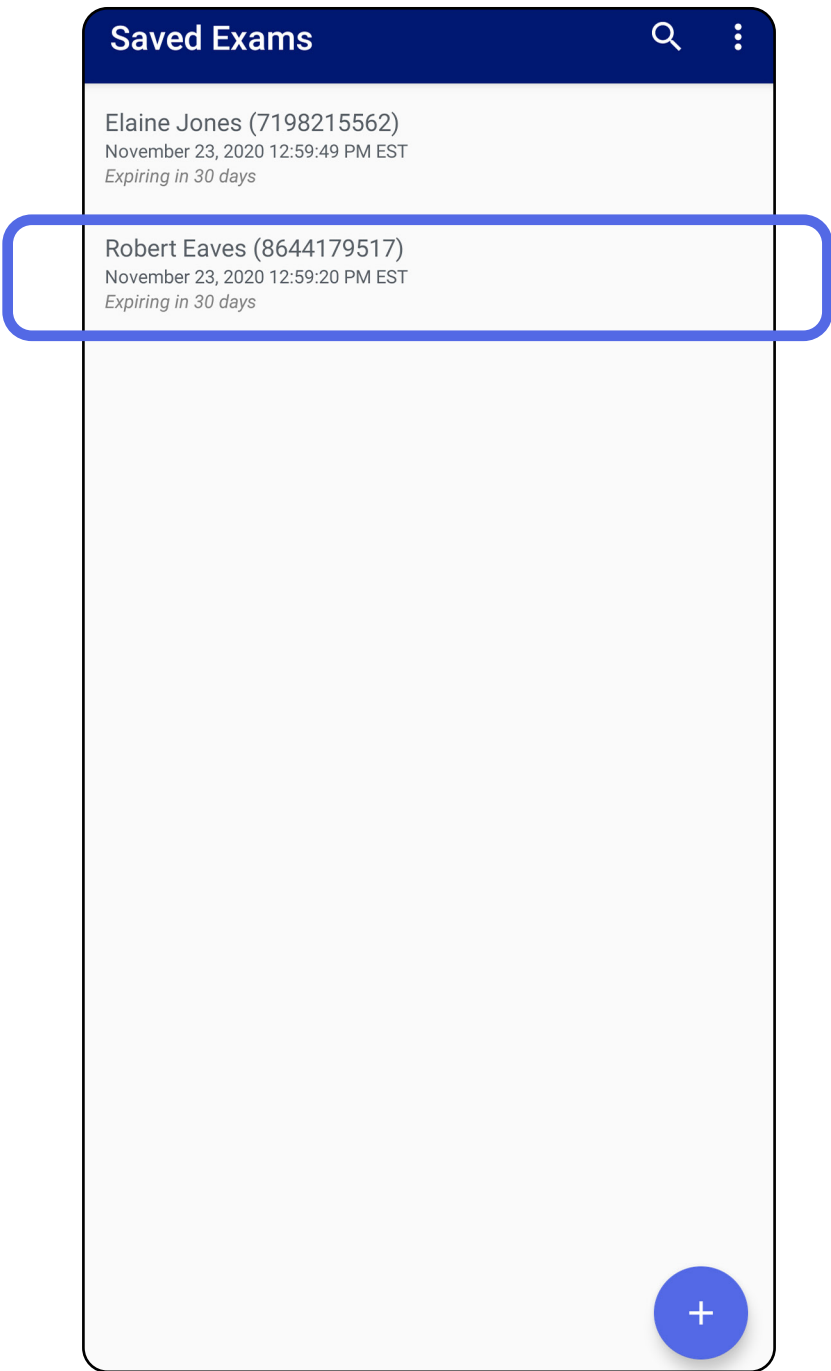

- 2. Klicka på det fält som ska uppdateras på skärmen Exam (Undersökning).

3. Ange patientinformationen.
 - a. Använd popup-tangentbordet eller den numeriska knappsatsen för att ange Patient name (Patientnamn) eller MRN (Journalnummer).
 - b. Använd popup-kalendern för att välja födelsedatum.



ANM. Kalenderformatet varierar beroende på Android-version.

4. Lägg till eller ta bort bilder. Se [Ta bilder \(Android\)](#) och [Filtrera, flytta och radera bilder \(Android\)](#).
5. Tryck på **Save** (Spara).




ANM. Det går bara att spara när det finns ändringar och de obligatoriska patientuppgifterna har angetts.

Gå till *Använda listan med appfunktioner*


Dela en undersökning (Android)

Passar: Utbildningsläge, kliniskt läge


1. Tryck på  på skärmen Exam (Undersökning).
2. Välj delningsmetod på popup-menyn.



ANM. Delningsikonen är bara tillgänglig om det finns minst en bild och de obligatoriska patientuppgifterna i undersökningen.

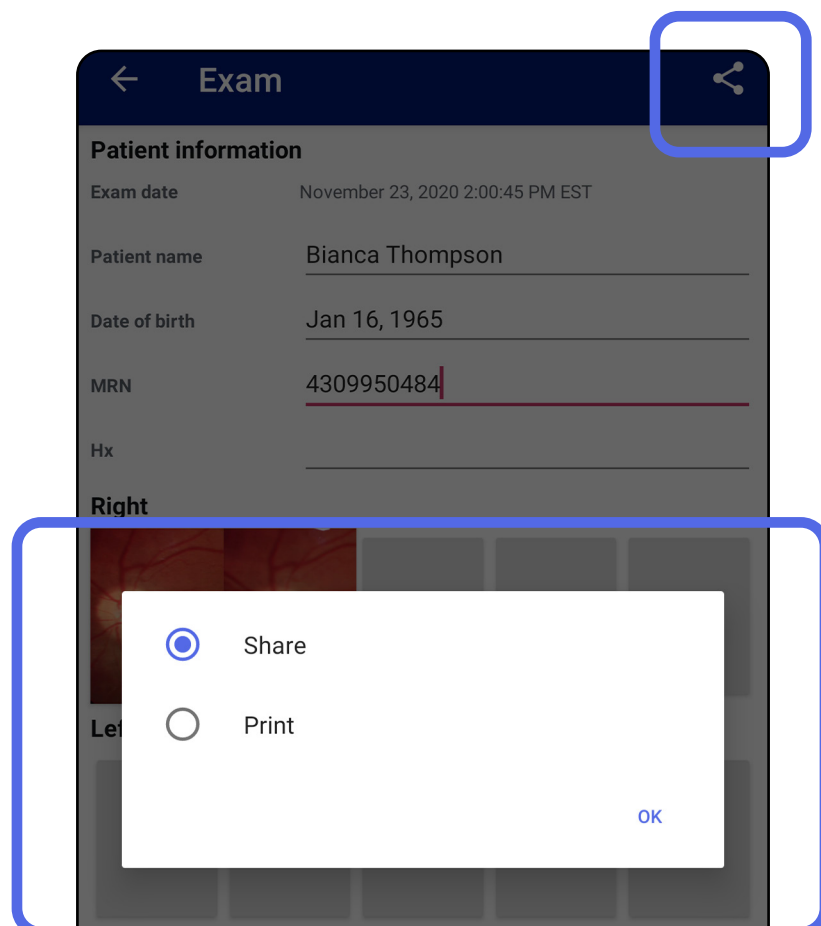

3. Följ uppmaningarna för att dela.

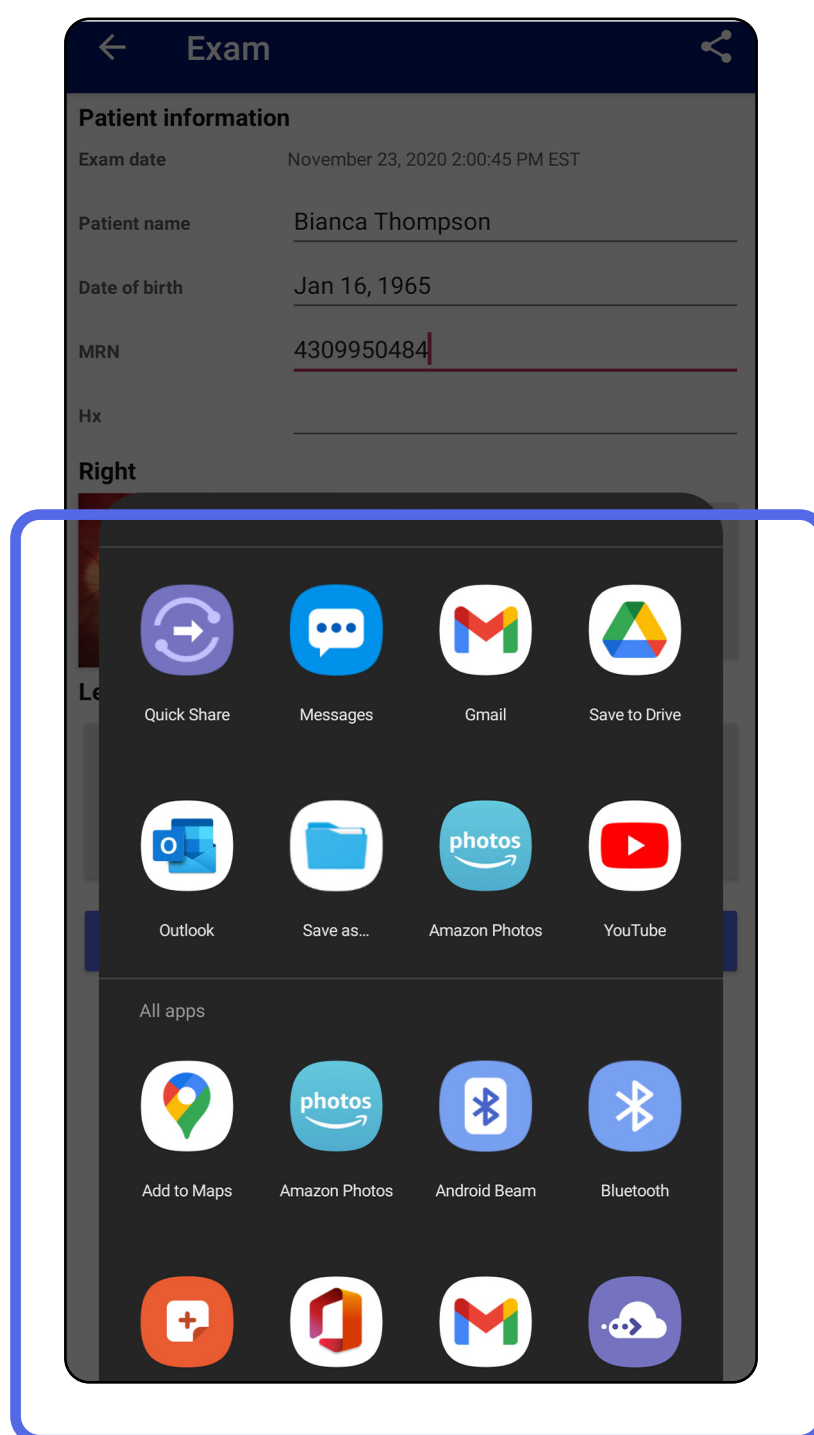

ANM. Se [Enhets- och patientdata samt säkerhet](#).



ANM. Delade bilder från **iExaminer**-appen kan ha inbäddad information. Vissa fotovisningsprogram stöder inte inbäddad information. Om mottagaren inte kan visa fotot bör mottagaren kontrollera att fotovisningsprogrammet stöder visning av bilder med inbäddad information eller välja ett annat program för fotovisning.

Gå till *Använda listan med appfunktioner*


Dela en bild (Android)

Passar: Utbildningsläge, kliniskt läge

1. Tryck på önskad bild på skärmen Exam (Undersökning).
2. Tryck på .




ANM. Delningsikonen är tillgänglig när de obligatoriska patientuppgifterna finns i undersökningen.

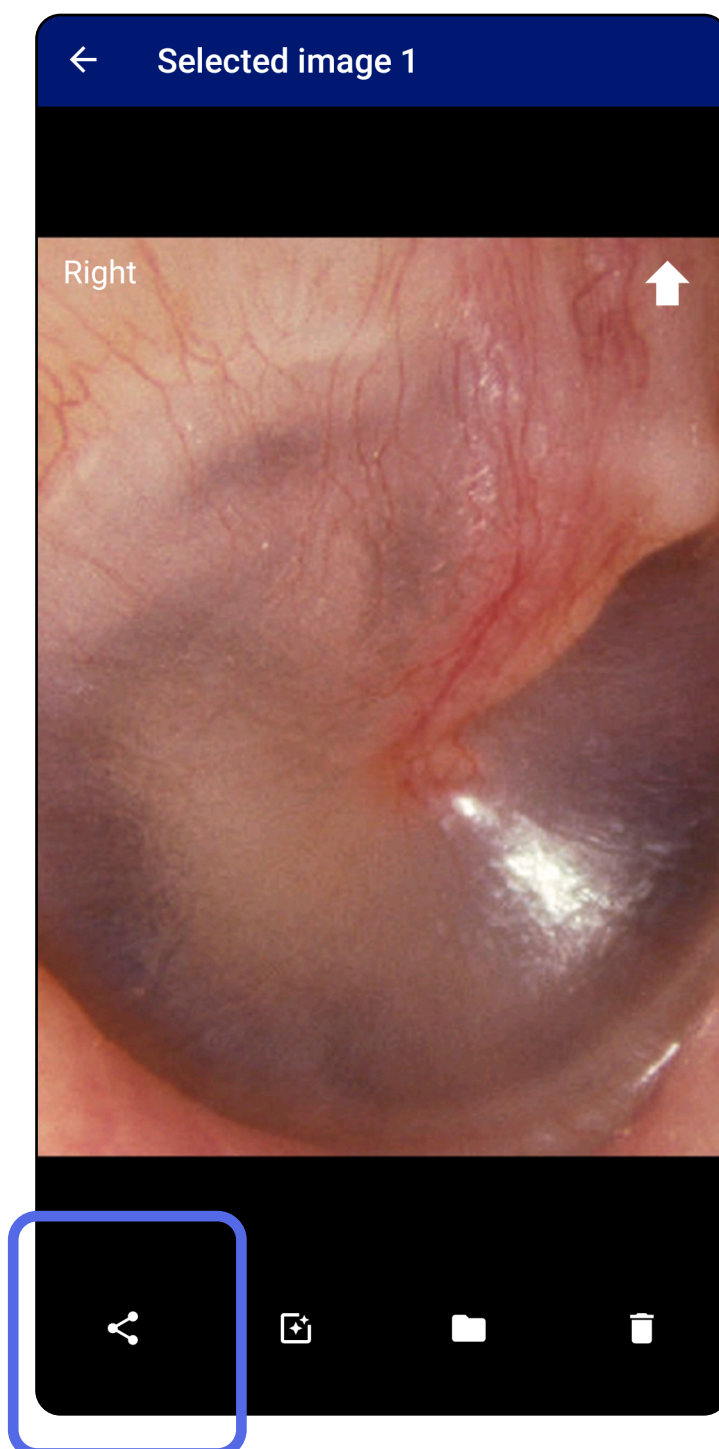

Gå till *Använda listan med appfunktioner*

3. Välj delningsmetod på popup-menyn.

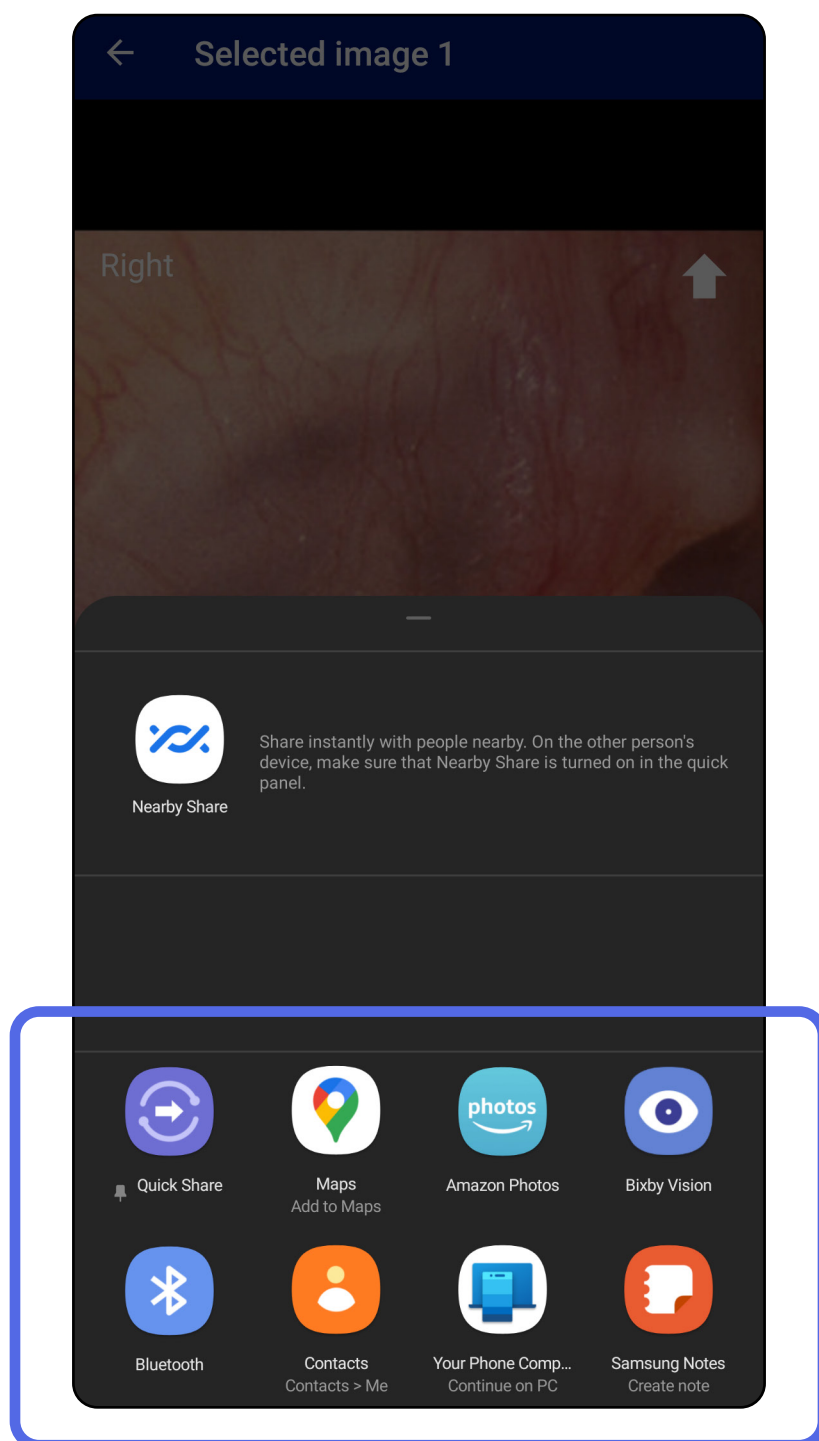

4. Följ uppmaningarna för att dela.



ANM. Se [Enhets- och patientdata samt säkerhet](#).




ANM. Delade bilder från **iExaminer**-appen kan ha inbäddad information. Vissa fotovisningsprogram stöder inte inbäddad information. Om mottagaren inte kan visa fotot bör mottagaren kontrollera att fotovisningsprogrammet stöder visning av bilder med inbäddad information eller välja ett annat program för fotovisning.

Gå till *Använda listan med appfunktioner*

Radera en undersökning (Android)

Passar: Utbildningsläge

Svep åt vänster eller höger på namnet för den förfallna undersökningen.

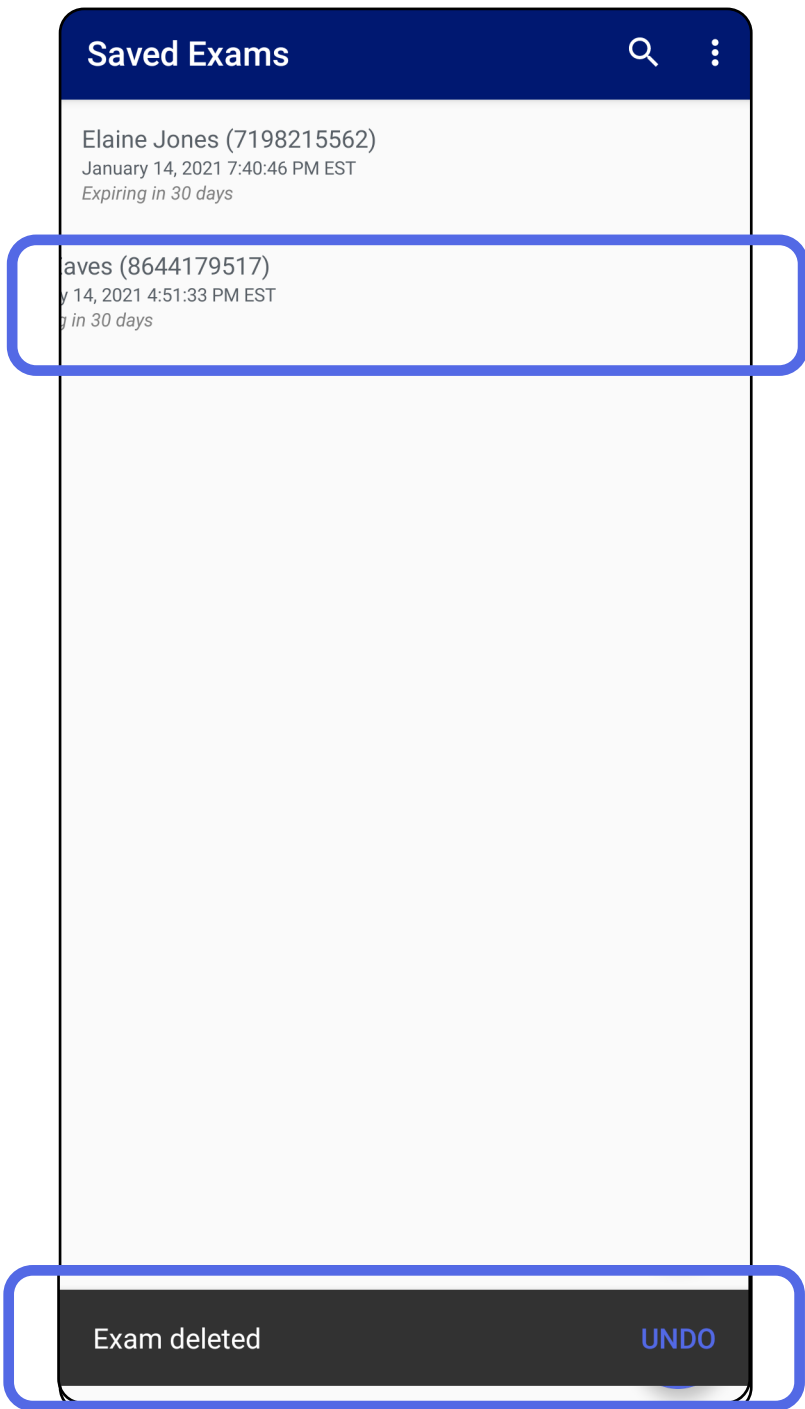


Tryck på **UNDO** (Ångra) inom 15 sekunder i popup-rutan för att ångra borttagningen.

Kassera en undersökning (Android)

Passar: Kliniskt läge

1. Om du vill kassera undersökningen trycker du på **New** (Ny).

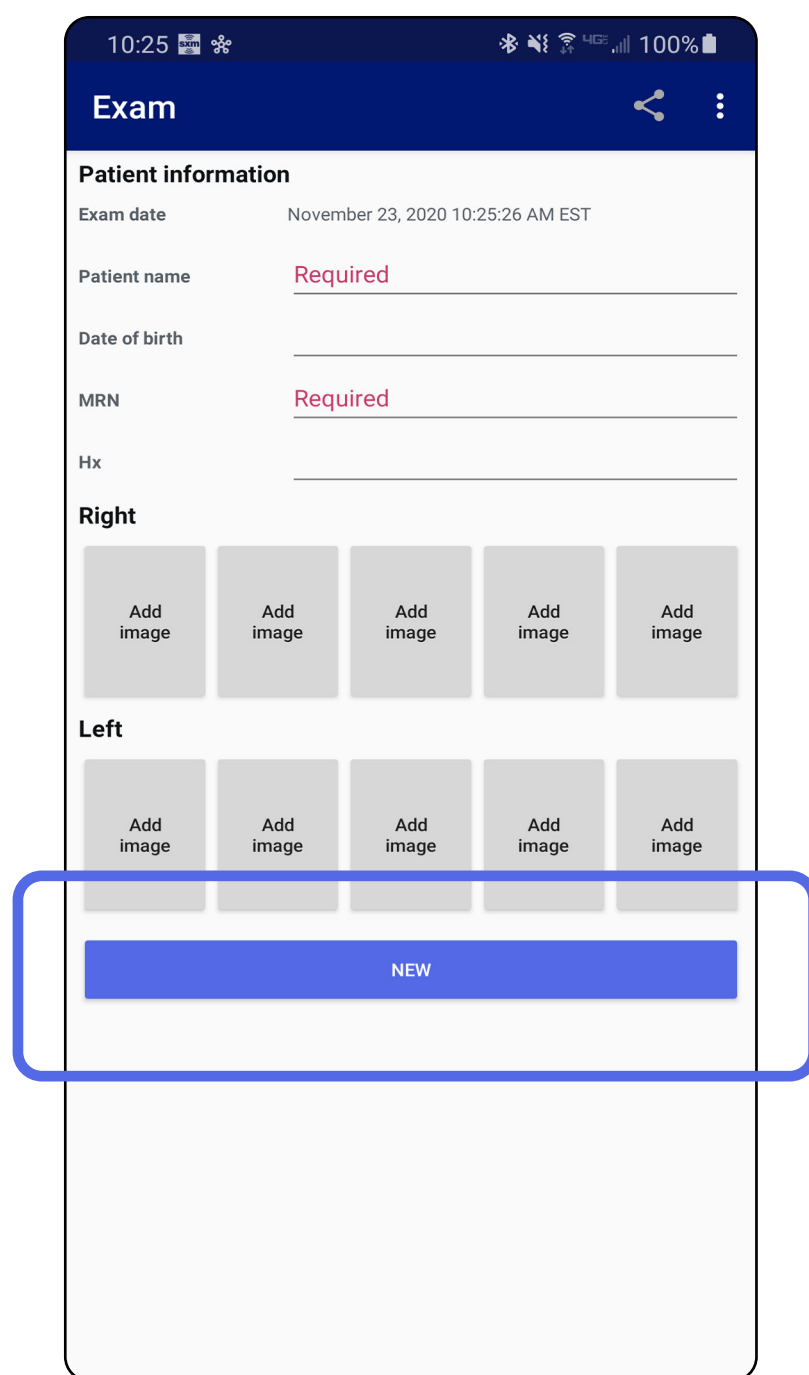

2. Tryck på **OK** för att ignorera ändringarna och starta en ny undersökning.

Gå till *Använda listan med appfunktioner*

Rengöring

Dessa rengöringsinstruktioner gäller **SmartBracket** och **SmartClip**. Se aktuell bruksanvisning för att få information om rekonditionering av Welch Allyn-enheter.



FÖRSIKTIGHET Sterilisera inte **SmartBracket** eller **SmartClip** och sänk inte ned dem i vätska.

Inget annat förebyggande underhåll än rengöring krävs för den här produkten.

Godkända rengöringskemikalier:

- 70 % isopropylalkohol (till exempel **CiDehol** 70-rengöringsdukar med alkohol)
 - **Metrex CaviWipes**
 - PDI Super-**Sani-Cloth**
 - PDI-**Sani-Cloth** Plus
1. Ta bort **SmartBracket** från huvudet och **SmartClip** innan du rengör det. Låt **SmartClip** sitta kvar på fodralet.
 2. Torka av **SmartBracket** och **SmartClip** med godkända rengöringskemikalier (se ovan) så att all synlig och osynlig smuts avlägsnas. Frekvens: Rengör vid behov.
 3. Låt rengöringslösningen torka.

Säker avfallshantering

Kassering av **SmartBracket** och **SmartClip** måste ske i enlighet med följande steg:

1. Följ anvisningarna för rengöring i det här avsnittet av användarhandboken.
2. Sortera material inför återvinningsprocessen.
 - Komponenterna ska demonteras och återvinnas baserat på typ av material:
 - o Plast ska återvinnas som plastavfall.
 - o Metall ska återvinnas som metall.
 - Innefattar skruvar och fästen.

Se aktuell huvudbruksanvisning för att få instruktioner om kassering.

Följ tillverkarens instruktioner för kassering av smarttelefon och -fodral. Radera alla befintliga data som rör patienter/sjukhus/klinik/läkare för att upprätthålla sekretessen. Säkerhetskopiering av data kan utföras före raderingen.

Användarna måste följa alla federala, statliga, regionala och/eller lokala lagar och förordningar som gäller säker kassering av medicinsk utrustning och tillbehör. Vid tveksamhet ska användaren av enheten i första hand kontakta Hillrom tekniska support för råd om säker kassering.

EMC-överensstämmelse

Information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) finns på Hillrom webbplats: hillrom.com.

Förvaring och transport

Se bruksanvisningen för aktuell Welch Allyn-enhet.

Tillbehör

Se aktuell bruksanvisning för Welch Allyn-enheten avseende tillbehör och patientnära delar.

Kompatibla enheter

Se bruksanvisningen för aktuell Welch Allyn-enhet.

Garanti

Welch Allyn, Inc. garanterar att Welch Allyn iExaminer SmartBracket och SmartClip är fria från defekter med avseende på material och utförande och att de fungerar i enlighet med tillverkarens specifikationer under en period av ett år från inköpsdatumet. Om det här instrumentet visar sig vara defekt eller icke-överensstämmande med tillverkarens specifikationer under garantiperioden reparerar eller ersätter Welch Allyn instrumentet eller komponenten utan kostnad för köparen. Den här garantin gäller endast Welch Allyn iExaminer SmartBracket och SmartClip som köpts nya från Welch Allyn eller dess auktoriserade distributörer eller representanter. Köparen måste returnera SmartBracket och SmartClip direkt till Welch Allyn eller en auktoriserad distributör eller representant och stå för fraktkostnaden.

Den här garantin täcker inte skador eller fel på grund av manipulering, felaktig användning, försummelse, olyckor, modifieringar eller frakt. Garantin upphör att gälla om instrumentet inte används i enlighet med tillverkarens rekommendationer eller om det repareras.